



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0006.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | КШЗ 147х35 №222 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 177,7 | <p>00008</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 85 | |
| $L, \text{мм.}$ | 378 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0007.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/147 №6968 |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» |

| | |
|--|--|
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. |
|--|--|

| | |
|-----|--|
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. |
|-----|--|

| | | |
|------------------|-------|--------------|
| $d2, \text{мм.}$ | 178,0 | <p>00009</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 95 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
|---|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Специалист Каманцев С.С. | <p>уд. № НОАП-0057-8175</p> |
|--------------------------|-----------------------------|



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru


Акт дефектоскопии №1.0008.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|--|-------------|---|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, УЗД. |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» |
| Наименование и № оборудование | | Переводник П 3-147/BC146 №21000 |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 А70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. |
| $d3, \text{мм.}/d2, \text{мм.}$ | 178,3/146,7 | <p>наклонный преобразователь 00010</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 101 | |
| $L, \text{мм.}$ | 315 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**

Дата проведения следующей плановой проверки

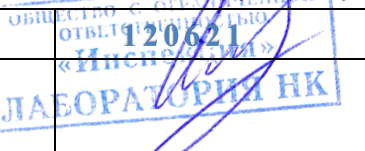

или 500 свинчиваний/развинчиваний

Специалист Каманцев С.С.

уд. № НОАП-0057-8175



ООО «Инспекция»

Лаборатория неразрушающего контроля

№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0009.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------|---|--|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, УЗД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник П 3-147/БТС168 №21003 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| d_2 , мм. | 178,0 |  | |
| d_1 , мм. | 102 | | |
| L , мм. | 306 | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний | |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 | |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0010.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-171/147 №15181 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 203,0/178,0 | <p>00012</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 101 | |
| $L, \text{мм.}$ | 425 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0011.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------------|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, УЗД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник М 3-152/147 №16194 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 А70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.}/d2, \text{мм.}$ | 197,0/178,0 |  | |
| $d1, \text{мм.}$ | 90 | | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | |  | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru


Акт дефектоскопии №1.0012.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» |
| Наименование и № оборудование | КШЗ 147х35 №220 |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» |

| | |
|--|--|
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. |
|--|--|

| | |
|-----|--|
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. |
|-----|--|

| | |
|------------------|-------|
| $d2, \text{мм.}$ | 178,1 |
| $d1, \text{мм.}$ | 85 |
| $L, \text{мм.}$ | 380 |

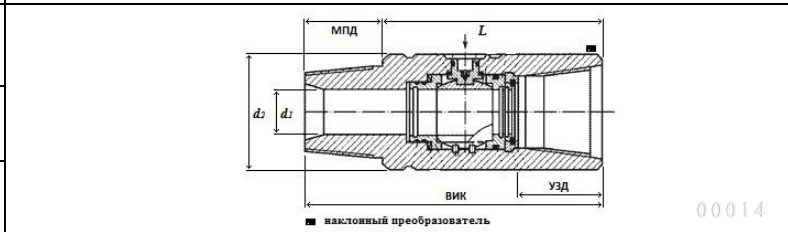


Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
|---|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Специалист Каманцев С.С. | уд. № НОАП-0057-8175 |
|--------------------------|----------------------|

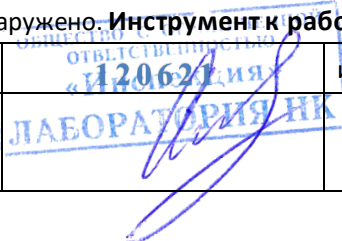



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0013.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | КШЗ 102x35 №312 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 120,5 | <p>00015</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 54 | |
| $L, \text{мм.}$ | 316 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0014.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | КШЗ 102x35 №311 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 120,5 | <p>00016</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 54 | |
| $L, \text{мм.}$ | 316 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0015.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» |
| Наименование и № оборудование | КШЗ 133х35 №302 |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» |

| | |
|--|--|
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. |
|--|--|

| | |
|-----|--|
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. |
|-----|--|

| | | |
|------------------|-------|--------------|
| $d2, \text{мм.}$ | 168,0 | <p>00015</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 70 | |
| $L, \text{мм.}$ | 387 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
|---|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Специалист Каманцев С.С. | <p>уд. № НОАП-0057-8175</p> |
|--------------------------|-----------------------------|



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0016.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | КШЗ 133х35 №301 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 168,0 | <p>00015</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 70 | |
| $L, \text{мм.}$ | 387 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0017.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | |
|------------------------------------|--|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-РКНТ40/102 №5951 |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» |

| | |
|--|--|
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. |
|--|--|

| | |
|-----|--|
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. |
|-----|--|

| | | |
|------------------|-------|--------------|
| $d2, \text{мм.}$ | 133,2 | <p>00019</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 54 | |
| $L, \text{мм.}$ | 415 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
|---|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Специалист Каманцев С.С. | <p>уд. № НОАП-0057-8175</p> |
|--------------------------|-----------------------------|



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0018.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/147 №6953 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 178,0 | <p>00020</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 95 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0019.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/147 №6966 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 178,0 | <p>00021</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 95 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0020.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/147 №6964 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 178,0 | <p>00022</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 95 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0021.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/147 №6969 |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» |

| | |
|--|--|
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. |
|--|--|

| | |
|-----|--|
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. |
|-----|--|


| | | |
|------------------|-------|--------------|
| $d2, \text{мм.}$ | 178,0 | <p>00023</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 95 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
|---|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Специалист Каманцев С.С. | уд. № НОАП-0057-8175 |
|--------------------------|----------------------|

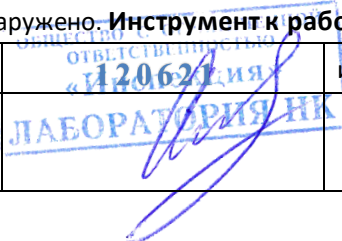



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0022.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|--|----------------------|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник П 3-133/147 №6973 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/178,0 | <p>00024</p> | |
| $d1, \text{мм.}$ | 89 | | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | <p>или 500 свинчиваний/развинчиваний</p> | |
| Специалист Каманцев С.С. | | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0023.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля



| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/147 №6971 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/178,0 | <p>00025</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 89 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | <p>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «120621» ЛАБОРАТОРИЯ НК</p> | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0024.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|--|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/147 №6975 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/178,0 |  |
| $d1, \text{мм.}$ | 89 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки |  | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0025.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/147 №6974 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| d3, мм./ d2, мм. | 168,0/178,0 | <p>00027</p> |
| d1, мм. | 89 | |
| L, мм. | 440 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | <p>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ № 120621 ЛАБОРАТОРИЯ НК</p> | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0026.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|--|--|--------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/147 №6972 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/178,0 | <p>00028</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 89 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**


| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633


www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0027.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|--|--|--|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/147 №6970 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/178,0 |  |
| $d1, \text{мм.}$ | 89 | |
| $L, \text{мм.}$ | 440 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**
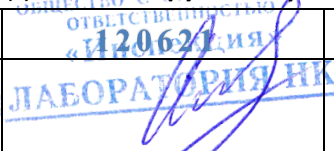
| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки |  | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0028.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник П 3-133/102 №17006 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/127,0 | <p>00030</p> | |
| $d1, \text{мм.}$ | 54 | | |
| $L, \text{мм.}$ | 450 | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний | |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 | |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0029.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник П 3-133/102 №17005 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/127,0 | <p>00031</p> | |
| $d1, \text{мм.}$ | 54 | | |
| $L, \text{мм.}$ | 450 | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний | |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 | |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0030.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/102 №17004 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/127,0 | <p>00032</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 54 | |
| $L, \text{мм.}$ | 450 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0031.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/133 №6950 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 178,0/168,0 | <p>00033</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 83 | |
| $L, \text{мм.}$ | 425 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | <p>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «120621» ЛАБОРАТОРИЯ НК</p> | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0032.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/133 №6948 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 178,0/168,0 | <p>00034</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 83 | |
| $L, \text{мм.}$ | 425 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0033.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/133 №6947 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 178,0/168,0 | <p>00035</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 83 | |
| $L, \text{мм.}$ | 425 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0034.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/171 №138 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 178,0/202,0 | <p>00036</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 102 | |
| $L, \text{мм.}$ | 397 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0035.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-147/НКТ60/147 №383 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 177,2 | <p>00037</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 80 | |
| $L, \text{мм.}$ | 393 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0036.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник Н 3-152/102Л №6296 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, мм./d2, мм.$ | 197,0/127,0 | <p>00038</p> |
| $d1, мм.$ | 54 | |
| $L, мм.$ | 165 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0037.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник Н 3-152/83 №6301 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, мм./d2, мм.$ | 197,0/108,0 | |
| $d1, мм.$ | 51 | |
| $L, мм.$ | 167 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0038.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник Н 3-152/83 №6302 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, мм./d2, мм.$ | 197,0/108,0 | <p>00040</p> |
| $d1, мм.$ | 51 | |
| $L, мм.$ | 167 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0039.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник Н 3-152/РКДС38 №6298 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 197,0/127,0 | | |
| $d1, \text{мм.}$ | 54 | | |
| $L, \text{мм.}$ | 164 | | |
| 00041 | | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний | |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 | |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0040.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник Н 3-152/РKDS38 №6297 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, мм./d2, мм.$ | 197,0/127,0 | | |
| $d1, мм.$ | 54 | | |
| $L, мм.$ | 162 | | |
| 00042 | | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0041.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник Н 3-152/133Л №6318 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, мм./d2, мм.$ | 197,0/168,0 | <p>00043</p> |
| $d1, мм.$ | 70 | |
| $L, мм.$ | 235 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0042.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник Н 3-152Л/152Л №17126 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 197,0/168,0 |  | |
| $d1, \text{мм.}$ | 70 | | |
| $L, \text{мм.}$ | 235 | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний | |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 | |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81А140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0043.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|--|---|--|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник М 3-147/117 №17860 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 А70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.}/d2, \text{мм.}$ | 178,0/146,0 | <p>наклонный преобразователь 00045</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 71 | |
| $L, \text{мм.}$ | 435 | |

Заключение

На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. **Инструмент к работе годен.**

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Дата проведения следующей плановой проверки | <p>12062 «Инспекция» ЛАБОРАТОРИЯ НК</p> | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0044.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/РНКНТ40 №5941 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/133,0 | <p>00046</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 68 | |
| $L, \text{мм.}$ | 420 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0045.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-РНКНТ40/102 №5948 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 168,0/133,0 | <p>00047</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 68 | |
| $L, \text{мм.}$ | 420 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0046.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| Метод (вид) контроля | | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | | Переводник Н 3-152/147 №6320 | |
| В условиях | | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, мм./d2, мм.$ | 197,0/178,0 | | |
| $d1, мм.$ | 75 | | |
| $L, мм.$ | 235 | | |
| 00048 | | | |
| Заключение | | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний | |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 | |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0047.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля



| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | УЗ-КС213СТ №241838 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 178,0 | |
| $d1, \text{мм.}$ | 101 | |
| $L, \text{мм.}$ | 485 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0048.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля
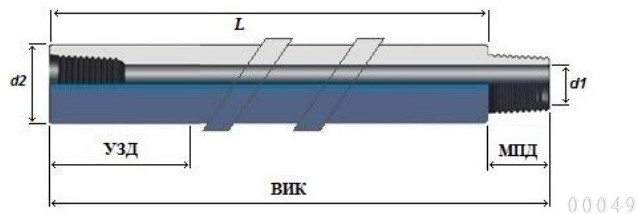
| | | |
|---|--|--|
| Метод (вид) контроля | ВИК, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | УЗ-КС219.1СТ №292147 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d2, \text{мм.}$ | 178,0 |  |
| $d1, \text{мм.}$ | 100 | |
| $L, \text{мм.}$ | 482 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки |  | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |



ООО «Инспекция»
Лаборатория неразрушающего контроля
№ 81A140633

www.inspection86.ru

Акт дефектоскопии №1.0049.1 от 13.01.2021 г. по результату неразрушающего контроля

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Метод (вид) контроля | ВИК, УЗД, МПД. | |
| Наименования организации заказчика | ООО «РИ-Пионер» | |
| Наименование и № оборудование | Переводник П 3-133/ОТТМ340 №128 | |
| В условиях | БПО ООО «РИ-Пионер» | |
| Приборы и инструменты, использованные при НК | Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № MAG 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis 7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г., D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г.. | |
| НТД | РД 03-606-03, РД 13-05-2006, РД 41-01-25-89, РД 39-013-90. | |
| $d3, \text{мм.} / d2, \text{мм.}$ | 162,3/340,0 | <p>00051</p> |
| $d1, \text{мм.}$ | 298 | |
| $L, \text{мм.}$ | 375 | |
| Заключение | | |
| На момент проведения диагностики, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен. | | |
| Дата проведения следующей плановой проверки | | или 500 свинчиваний/развинчиваний |
| Специалист Каманцев С.С. | | уд. № НОАП-0057-8175 |