

Заключение №2.0223.1

заказчик	исполнитель
ООО «РИ-Пионер»	ООО «Инспекция»


дата	место проведения
25.02.2021г.	БПО ООО «РИ-Пионер»

Наименование inspected instrument
Элеватор КМ 102/120 №3

методы контроля	НТД
ВИК, УЗД, МПД.	РД 41-01-25-89; МУ 0379-00.007.

используемые приборы и инструменты
Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № МАГ 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г..

Схема контроля:

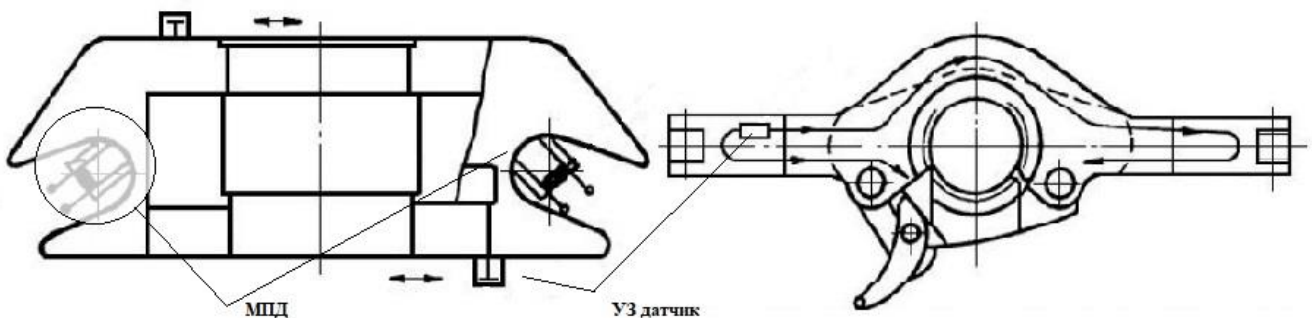

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

02670

На момент проведения дефектоскопии, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе **годен.**

Дата следующей плановой проверки	240821
----------------------------------	---------------

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

Заключение №2.0224.1

заказчик	исполнитель
ООО «РИ-Пионер»	ООО «Инспекция»


дата	место проведения
25.02.2021г.	БПО ООО «РИ-Пионер»

Наименование inspected instrument
Элеватор КМ 114/140 №56

методы контроля	НТД
ВИК, УЗД, МПД.	РД 41-01-25-89; МУ 0379-00.007.

используемые приборы и инструменты
Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № МАГ 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г..

Схема контроля:

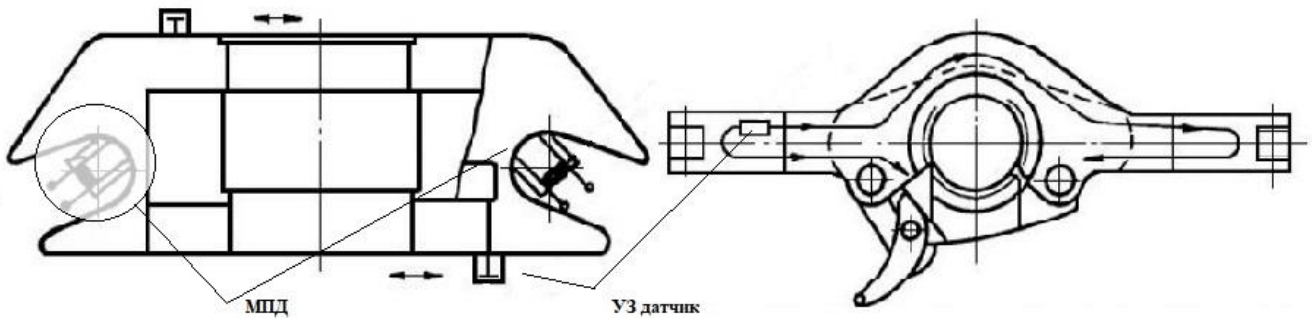

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

02682

На момент проведения дефектоскопии, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе годен.

Дата следующей плановой проверки	240821
----------------------------------	---------------

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)

Заключение №2.0225.1

заказчик	исполнитель
ООО «РИ-Пионер»	ООО «Инспекция»


дата	место проведения
25.02.2021г.	БПО ООО «РИ-Пионер»

Наименование inspected instrument
Элеватор КМ 114/140 №351

методы контроля	НТД
ВИК, УЗД, МПД.	РД 41-01-25-89; МУ 0379-00.007.

используемые приборы и инструменты
Набор ВИК № 299/15 поверен до 19.11.2021 г., магнитный дефектоскоп «МАГ-101» № МАГ 17066 поверке не подлежит, Magnavis WCP-2 белый фон поверен до 08.2022г. МП суспензия Magnavis7HF годен до 04.2022г., УЗ дефектоскоп А1212 Мастер №4141967 поверен до 18.11.2021г., ультразвуковой преобразователь S5096 5.0 A70D6CS поверен до 18.11.2021г.. D1771 4.0 A0D12CL № 1094500 поверен до 18.11.2021г..

Схема контроля:

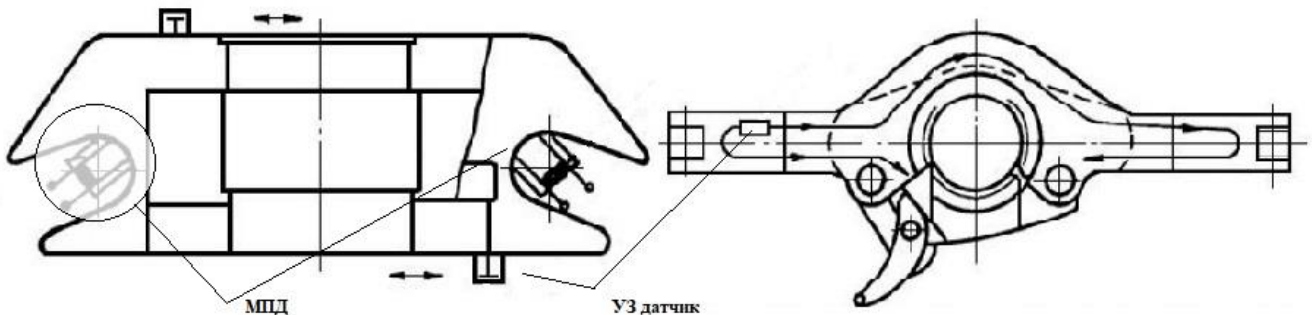

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

02694

На момент проведения дефектоскопии, дефектов не обнаружено. Инструмент к работе **годен.**

Дата следующей плановой проверки	240821
----------------------------------	---------------

Начальник ЛНК



Каманцев С.С. (уд. № НОАП-0057-8175)